

VŠEM ÚČASTÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
10.07.2017Naše značka
BY/52/2017Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/119Karlovy Vary
12.07. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „**Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 22**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 06. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-015246

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) Vám podáváme vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 22“, které vyplývá z níže uvedených dotazů.

Dotaz č. 1:

V příloze č. 2 Formulář technických specifikací pro IROP_I_22 Anesteziologický přístroj CHEB zadavatel požaduje:

„Provedení s plně elektronickými průtokoměry se záložním systémem pro přesné dávkování směsi čerstvých plynů“ a současně „Automatické elektronické směřování čerstvé směsi s ochranou proti podání hypoxické směsi s volbou nastavení celkového průtoku směsi čerstvých plynů při dané koncentraci“.

Účastník nabízí anesteziologický přístroj renomovaného nadnárodního výrobce obdobného technického řešení splňující medicínský účel zadání, běžně používaný na odděleních ARO, modulárně stavěný narkotizační přístroj pro vedení anestezie pacientů všech věkových skupin s elektronickým zobrazením průtokoměrů a hodnot nastavených průtoků na obrazovce ventilátoru.

Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel požaduje plně elektronické ovládání nastavení průtoku jednotlivých plynů bez mechanických regulačních prvků s plně elektronickým nastavením dané koncentrace a průtoku požadované směsi čerstvých plynů a s nastavením koncentrace dodávky směsi plynů pomocí záložního (mechanického) systému dodávky směsi čerstvých plynů při poruše elektronického ovládání dodávky směsi čerstvých plynů.

Zadavatel trvá na dané technické specifikaci a nebude akceptovat navrhované řešení účastníka zadávacího řízení.

Dotaz č. 2:

V příloze č. 2 Formulář technických specifikací pro IROP_I_22 Anesteziologický přístroj CHEB zadavatel požaduje monitor vitálních funkcí stejného výrobce pro jednoduché ovládání celé sestavy.

Účastník předpokládá, že se zadavatel ztotožňuje s doporučením na základě stanoviska České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP k přístrojové monitoraci hloubky nervosvalové blokády (NSB), a tudíž požaduje monitor vitálních funkcí doplněný o modul pro monitoraci hloubky NSB.


Je tento předpoklad správný?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel považuje anesteziologický přístroj s monitorem životních funkcí jako sestavu jednoho anesteziologického pracoviště s jednotným systémem a propojením ovládání celé sestavy, s jednotným uživatelským prostředím v českém jazyce pro nejvyšší míru bezpečnosti ovládání a provozu celé sestavy.

Modul pro měření hloubky nervosvalové blokády není v zadávací dokumentaci požadován.

Zadavatel trvá na dané technické specifikaci.

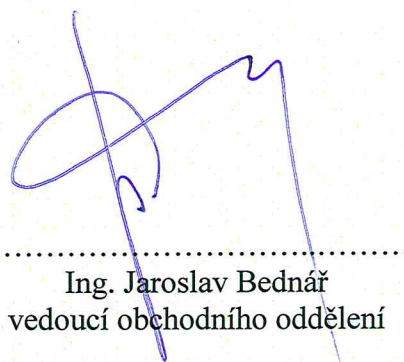

.....
Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení