

VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
27.07.2020

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
29. 07. 2020

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Vybavení hematologických laboratoří KKN**”

Dotaz č. 1:

Zadavatelem v Příloze č. 1 POŽADAVKY PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ANALYZÁTORY KREVNÍCH OBRAZŮ A DIGITÁLNÍ MORFOLOGIE FORMOU ZÁPŮJČKY ZA NÁKUP REAGENCIÍ uvedl „Kontrolní materiál dle doporučení ČHS“. Pro přesné určení nákladů kontrolních materiálů žádáme o stanovení počtu provozních dnů laboratoří např. 365 dnů (nepřetržitý provoz), 250 dnů (pouze v pracovní dny) a počtu/četnosti kontrol pro každou hladinu. Četnost kontrol si ve většině případů stanovuje laboratoř svými interními předpisy.

Dotaz zní: Může zadavatel blíže specifikovat a doplnit do níže uvedené tabulky počet provozních dnů a četnost kontrol?

Provádění kontrol s četností:

1D=1x denně | 1T=1x týdně tj. 4x měsíčně | 2T=2x týdně, tj. 8x měsíčně | 3T=3x týdně, tj. 12x měsíčně | 4T=4x týdně, tj. 16x měsíčně | 1M=1x měsíčně | 2M=2x měsíčně | 2R=2x ročně.

Hlavní analyzátor KV - počet provozních dnů: „doplní zadavatel“

	KO+Diff			KO+reti			KO+Diff+reti		
	HIGH	LOW	NORMAL	HIGH	LOW	NORMAL	HIGH	LOW	NORMAL
Hladina									
Četnost									

Vedlejší analyzátor KV - počet provozních dnů: „doplní zadavatel“

	KO+Diff			KO+reti			KO+Diff+reti		
	HIGH	LOW	NORMAL	HIGH	LOW	NORMAL	HIGH	LOW	NORMAL
Hladina									
Četnost									

HEM 1 Cheb – počet provozních dnů: „doplň zadavatel“

	KO+Diff			KO+reti			KO+Diff+reti		
Hladina	HIGH	LOW	NORMAL	HIGH	LOW	NORMAL	HIGH	LOW	NORMAL
Četnost									

HEM 2 Cheb – počet provozních dnů: „doplň zadavatel“

	KO+Diff			KO+reti			KO+Diff+reti		
Hladina	HIGH	LOW	NORMAL	HIGH	LOW	NORMAL	HIGH	LOW	NORMAL
Četnost									

Dotaz č. 2:

Ve smlouvě o výpůjčce (článek II., bod 2.) je uvedeno: „Půjčitel prohlašuje, že přístroje jsou staré max. 3 roky od data výroby“.

V příloze č. 3 Formulář technických specifikací je uvedeno, že stáří max. 3 roky se týká pouze hematologických přístrojů, nátěrového a barvícího automatu.

Dotaz: Stáří přístrojů max. 3 roky se týká pouze hematologických přístrojů, nátěrového a barvícího automatu tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 Formulář technické specifikace nikoliv všech přístrojů, jak je uvedeno ve smlouvě o výpůjčce?

Odpověď na dotaz č. 1:
Hlavní analyzátor KV - počet provozních dnů: 365

	KO+Diff			reti		
Hladina	HIGH	LOW	NORMAL	HIGH	LOW	NORMAL
Četnost	10T	10T	10T	2T	2T	3T

Vedlejší analyzátor KV - počet provozních dnů: 365


	KO+Diff			reti		
Hladina	HIGH	LOW	NORMAL	HIGH	LOW	NORMAL
Četnost	10T	10T	10T	2T	2T	3T

HEM 1 Cheb – počet provozních dnů: 365

	KO+Diff			reti		
Hladina	HIGH	LOW	NORMAL	HIGH	LOW	NORMAL
Četnost	10T	10T	10T	2T	2T	3T

HEM 2 Cheb – počet provozních dnů: 365


	KO+Diff			reti		
Hladina	HIGH	LOW	NORMAL	HIGH	LOW	NORMAL
Četnost	10T	10T	10T	2T	2T	3T



Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, část určená přímo k vyhodnocování (Digitální morfologie buněk periferní krve – automat) nemusí splňovat podmínku 3 let.

Současně zadavatel upozorňuje, že **prodlužuje termín pro podání nabídky, a to do 14.8.2020, do 10:00 hod.**

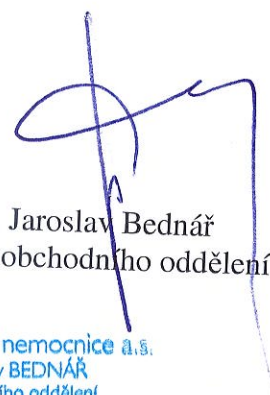

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Ing., Bc. Jaroslav BEDNÁŘ
vedoucí obchodního oddělení
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 114, 734 412 273
e-mail: jaroslav.bednar@kkn.cz