

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Váš dopis značka / ze dne
10 .05. 2022

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
12. 05. 2022

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**ReactEU-100_Hmotnostní spektrometr**”

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Příloze č. 3 ZD Formulář technických specifikací dodávky pro: Hmotnostní spektrometr mimo jiné uvedl požadavek:

„Efektivní a rychlý odečet vzorků – provede 400 až 500 identifikací za hodinu“

Námi nabízený přístroj má rychlost odečtu 1 vzorku za 12 s, tzn. 300 vzorků/hodinu.

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat námi nabízenou rychlost odečtu vzorků?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení, pokud bude zaručeno 300 identifikací za hodinu.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v Příloze č. 3 ZD Formulář technických specifikací dodávky pro: Hmotnostní spektrometr mimo jiné uvedl požadavek:

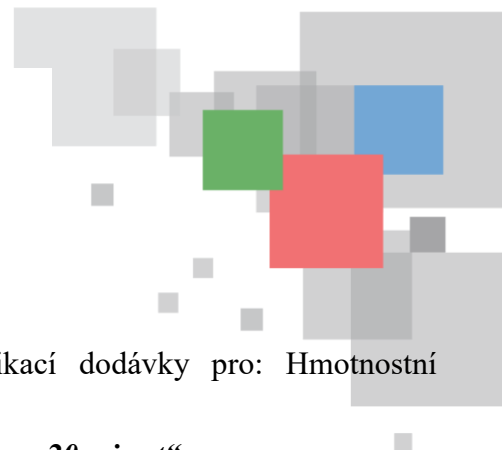
„Identifikace přímo ze směsi kultur pomocí speciálního modulu, který je součástí dodaného systému“

Námi nabízený přístroj umožňuje identifikaci směsné kultury i bez pomoci speciálního modulu.

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat námi nabízené řešení?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel akceptuje nabízené řešení.

**Dotaz č. 3:**

Zadavatel v Příloze č. 3 ZD Formulář technických specifikací dodávky pro: Hmotnostní spektrometr mimo jiné uvedl požadavek:

„Automatické čištění iontové optiky pomocí laserového záření max. 20 minut“

Námi nabízený přístroj nevyžaduje čištění iontové optiky pomocí laserového záření. Provozní údržba iontové optiky je prováděna automaticky speciální patentovanou technologií s časovým rozsahem do 20 minut. Další detailní kontrolu stavu optického systému navíc provádí servisní technik v rámci pravidelné půlroční bezpečnostně-technické kontroly.

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat námi nabízené řešení?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení v případě, že bude doložen konkrétní způsob čištění iontové optiky a bude doložena jeho účinnost, která je srovnatelná s čištěním pomocí laseru.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v Příloze č. 3 ZD Formulář technických specifikací dodávky pro: Hmotnostní spektrometr mimo jiné uvedl požadavek:

„Využití MALDI-TOF k detekci mechanismů rezistence v IVD režimu, detekce karbapenemáz a cefalosporináz“

Námi nabízený přístroj tento požadavek v současné době neumožňuje.

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat přístroj i bez tohoto parametru?

Odpověď na dotaz č. 4:

Ne, zadavatel nebude akceptovat přístroj bez tohoto parametru. Vzhledem k velkému nárůstu rezistentních kmenů za poslední dva roky zadavatel trvá na tomto parametru.

Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 13.6.2022, do 10:30 hod.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení