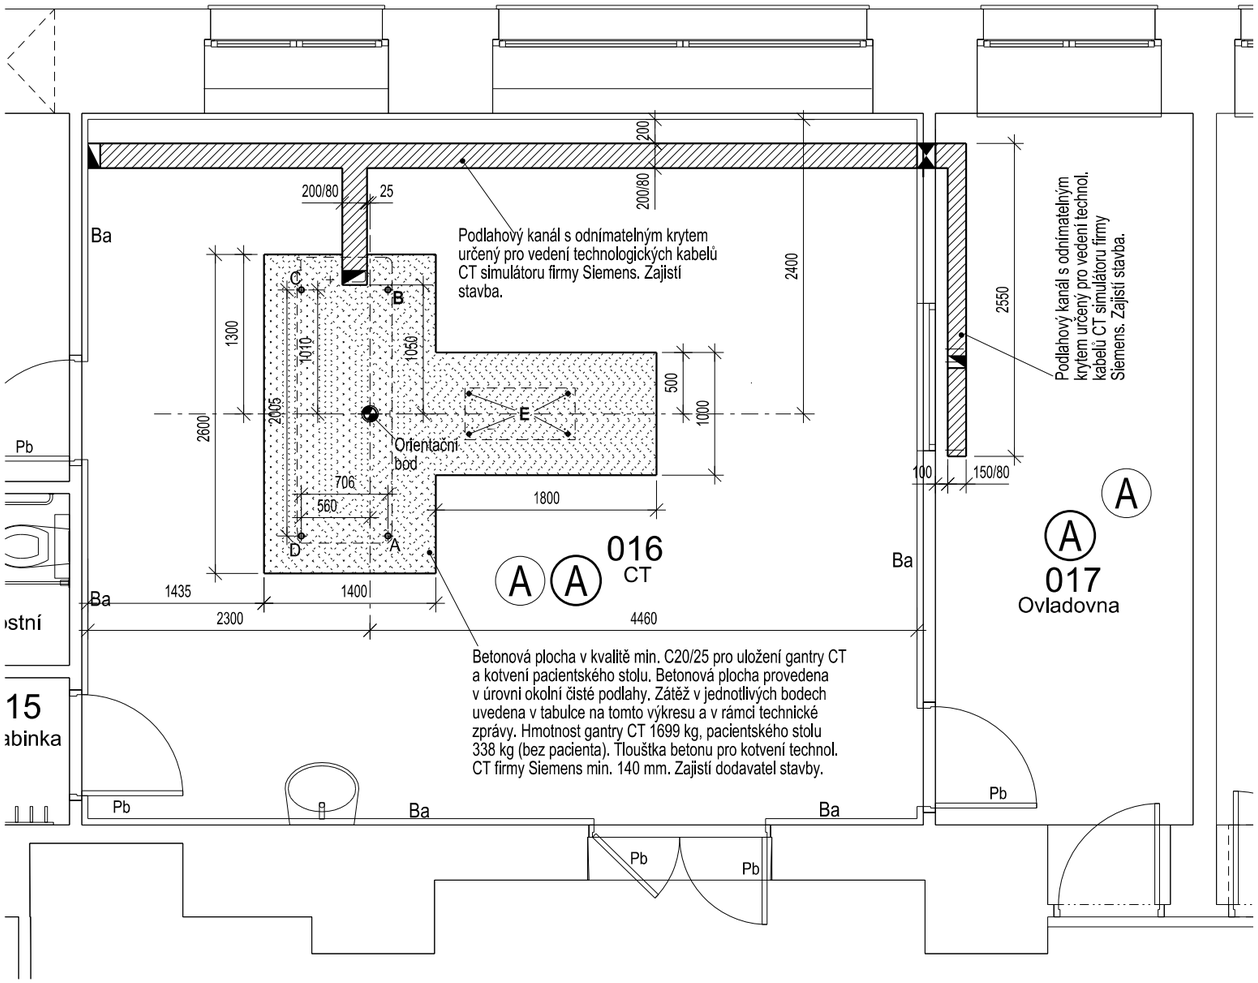

LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

(A) Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu $5x10^4$- 10^6Ohm.

Vyústění technologických kabelů kompletu CT simulátoru z podlahového kanýlu s odnímatelným krytem. Přesné umístění bude zhotovena dle konzultací se servisním technikem CT. Zajistí stavba.

Podlahový kanál s odnímatelným krytem určený pro vedení technologických kabelů přístroje CT firmy Siemens. Zaklopení podlahových kanálu provedeno až po instalaci technologie CT. Zajistí dodavatel stavby.

Kvalitní betovnová plocha pro uložení gantry CT a kotvení pacientského stolu CT firmy Siemens - provedena v úrovni okolní čisté podlahy (betonová plocha včetně podlahové krytiny). Zajistí stavba.

Pb Ochrana proti ionizujícímu záření na dveřích (Pb plech) - po provedení označit 30 mm vysokými písmeny s informací o tl. ochranné vrstvy. Zajistí dodavatel stavby.

Ba Ochrana proti ionizujícímu záření na stěnách provedena ze spec. barytové směsi popřípadě Pb plechu - po provedení označit 30 mm vysokými písmeny s informací o tl. ochranné vrstvy. Zajistí dodav. stavby.

Zatížení podlahy v bodech uložení gantry CT SOMATOM go.Sim firmy Siemens:

Bod (dle výkresu)	A	B	C	D
$F_{stat\ max}$ (N)	3 440	4 750	5 100	3 700
F_{dyn} (N)	+/- 300	+/- 300	+/- 300	+/- 300
Velikot plochy zatížení (cm^2)	16	16	16	16

Hmotnost gantry CT 1699 kg. Maximální síla působící na jeden bod při instalaci gantry CT 9 850 N.

E - body pro kotvení pacientského stolu technologie CT.
- extrakční síla působící v bodě kotvení pacientského stolu max. 4,2 kN.
- hmotnost pacientského stolu - cca 338 kg (bez pacienta).

POZNÁMKA:

Všechny míry jsou v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy. Dodržte kóty, dimenze a rozteče !

INVESTOR : Karlovarská krajská nemocnice a.s., K Nemocnici 1204/17, 350 02 Cheb

STAVBA: Karlovarská krajská nemocnice - Nemocnice v Chebu
Stavební úpravy pro instalaci CT simulátoru
SIEMENS Healthineers SOMATOM go.Sim

ZPRACOVATEL: Tomáš Václavík - Projekty lékařské technologie
Na Hroudách 6 č.p. 260, 288 02 Nymburk
Tel: +420 775 638 105, E-mail: projekty.vaclavik@gmail.com

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Tomáš Václavík
VYPRACOVAL: Tomáš Václavík

PROFESE: LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE
PŘÍLOHA: Půdorys 1.PP - Podlaha CT

PARÉ:

STUPEŇ:	DPS
DATUM:	10/2024
Č. ZAKÁZKY:	2024 - 041
FORMÁT:	2x A4
MĚŘÍTKO:	1 : 50
ČÍSLO PŘÍLOHY:	V - 0 2