


**Legenda potrubí:**  
potrubí kyslíku - MED O<sub>2</sub>  
kabel propojení klinické signalizace - JISTY 0,8x4 - Cu trubka 4 bar

**Poznámky:**  
**Poznámka č.01:** Potrubí medicínských plynů bude napojeno na stávající rozvod. Pro napojení na stávající rozvod je nutné na nezbytnou dobu přerušit dodávku medicínských plynů pro část nemocnice. Tato odstávka musí být koordinována s uživatelem.  
**Poznámka č.02:** Potrubí medicínských plynů bude vedeno v podhledu na konzolkách. Kotvení potrubí musí odpovídat vydané projektové dokumentaci PŘR.  
Svody potrubí pro:  
- ventilový box  
- lékařské panely  
budou vedeny v drážce pod omítkou.  
**Poznámka č.03:** Pro panel klinické signalizace je nutné přivést kabel 230V/6A přes samostatný jistič z obvodu VDO. Kabel bude ukončen v místě umístění panelu klinické signalizace a bude ponechán 1 m volný konec 1,6 m nad podlahou.  
**Poznámka č.04:** Ventilový box a panel klinického alarmu musí spříšovat normu ČSN EN ISO 7396-1 ed.2.  
**Poznámka č.05:** Vybavení ramp nad lůžky bude před realizací a dodáním na stavbu odsouhlaseno uživatelem.

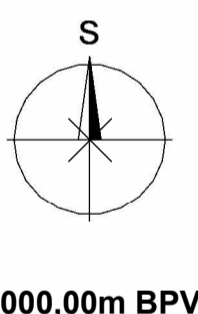

**penta**  
—projekt  
GENERÁLNÍ PROJEKTANT  
PENTA PROJEKT s.r.o.  
Městská 1188/12  
586 01 Jihlava  
IČ: 479 16 621  
+420 567 312 451  
www.pentaprojekt.cz  
penta@penta.ji.cz

**Nemocnice Karlovy Vary**  
Stavební úpravy pro usazení PET-CT

INVESTOR  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary  
IČ: 708 91 168

**D1.01 pavilon B**  
**D1.01.6 Medicinální plyn**

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU  
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.  
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU  
Ing. Aleš Prudký

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD  
Pipeline Design s.r.o.  
Frydlantská 1351/15  
460 01 Liberec 1  
IČ: 19364300  
+420 567 972 847  
jiri.stajer@pipeline-design.eu

VEDOUcí PROJEKTANT  
Ing. Arch. Jaromír Homolka, CSc.  
VYPRACOVAL  
Jiří Štajer  
KONTROLOVAL  
Rudolf Svoboda

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARE

ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE	NÁZEV VÝKRESU	STUPEŇ PD	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM
D1.01.6-11	R00	Půdorys 1NP	DPS	1 : 50	10x A4	11 / 2024
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO						
2024-11						

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb.)