



**VŠEM ÚČASTNÍKŮM  
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Váš dopis značka / ze dne  
21.07.2025

Naše značka

Vyřizuje / linka  
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary  
22.07.2025

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Dodávky jednorázových rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.**”

**Dotaz č. 1:**

Zadavatel v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění) v **části 2 – rukavice operační latexové bez pudru, sterilní** požaduje splnění minimálních požadovaných parametrů. V jednom z parametrů je požadována délka rukavic minimálně 280 mm. Uchazeč disponuje rukavicemi, které splňují všechny ostatní požadované parametry, avšak u menších velikostí rukavic (velikost 5,5-6,5) mají délku 260 mm a u velikostí 7-8 délku 270 mm. Ostatní velikosti již splňují minimální délku 280 mm.

*Bylo by pro zadavatele přístupné upravit minimální požadovanou délku rukavic na 260 mm? Tyto menší velikosti rukavic jsou v praxi standardně vyráběny v kratších délkách, přesto však plně vyhovují z hlediska ochranné funkce a všech ostatních parametrů.*

**Odpověď na dotaz č. 1:**


Zadavatel stanovil požadavek na minimální délku rukavic 280 mm v části 2 – rukavice operační latexové bez pudru, sterilní u všech nabízených velikostí z důvodu zajištění dostatečného krytí zápěstí a překrytí návleku operačního pláště. Tento požadavek vychází z požadavků zdravotnického personálu zadavatele a z jeho praktických zkušeností s používáním rukavic při operačních výkonech.

Nabídnuté rukavice s délkou 260 mm nejsou pro zadavatele akceptovatelné, neboť nehodlá slevit z požadavku na bezpečnost a komfort zdravotnického personálu. U kratších rukavic reálně hrozí vyhrnování rukávu pláště a odkrytí části předloktí, což může vést k narušení bariérové ochrany a zvýšení rizika kontaminace.

Zadavatel si je vědom, že běžně dostupné rukavice na trhu mají délku 280 mm i u menších velikostí, a v rámci průzkumu trhu zjistil, že většina relevantních dodavatelů nabízí rukavice splňující tento parametr.

Z výše uvedených důvodů zadavatel na požadavku minimální délky 280 mm u všech velikostí trvá.

---

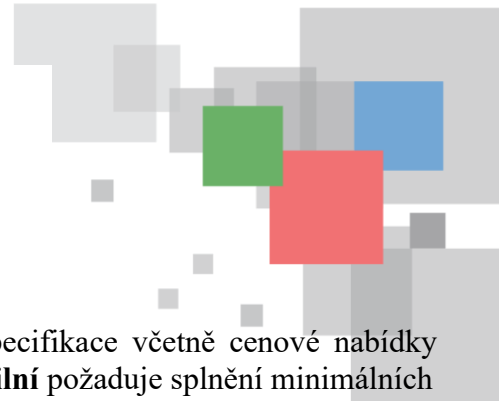**Dotaz č. 2:**

Zadavatel v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění) v **části 3 – rukavice operační latexové s pudrem, sterilní** požaduje splnění minimálních požadovaných parametrů. V jednom z parametrů je požadována délka rukavic minimálně 280 mm. Uchazeč disponuje rukavicemi, které splňují všechny ostatní požadované parametry, avšak u menších velikostí rukavic (velikost 6-6,5) mají délku 270 mm. Ostatní velikosti již splňují minimální délku 280 mm.

*Bylo by pro zadavatele přístupné upravit minimální požadovanou délku rukavic na 270 mm? Tyto menší velikosti rukavic jsou v praxi standardně vyráběny v kratších délkách, přesto však plně vyhovují z hlediska ochranné funkce a všech ostatních parametrů.*

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel stanovil požadavek na minimální délku rukavic 280 mm v části 3 – rukavice operační latexové s pudrem, sterilní u všech nabízených velikostí z důvodu zajištění dostatečného krytí zápěstí a překrytí návleku operačního pláště. Tento požadavek vychází z požadavků zdravotnického personálu zadavatele a z jeho praktických zkušeností s používáním rukavic při operačních výkonech.

Nabídnuté rukavice s délkou 270 mm nejsou pro zadavatele akceptovatelné, neboť nehodlá slevit z požadavku na bezpečnost a komfort zdravotnického personálu. U kratších rukavic reálně hrozí vyhrnování rukávu pláště a odkrytí části předloktí, což může vést k narušení bariérové ochrany a zvýšení rizika kontaminace.

Zadavatel si je vědom, že běžně dostupné rukavice na trhu mají délku 280 mm i u menších velikostí, a v rámci průzkumu trhu zjistil, že většina relevantních dodavatelů nabízí rukavice splňující tento parametr.

Z výše uvedených důvodů zadavatel na požadavku minimální délky 280 mm u všech velikostí trvá.

---


**Dotaz č. 3:**

Zadavatel v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění) v **části 7 – rukavice operační latexové se zvýšenou citlivostí bez pudru, sterilní** požaduje splnění minimálních požadovaných parametrů. V jednom z parametrů je požadována délka rukavic minimálně 280 mm. Uchazeč disponuje rukavicemi, které splňují všechny ostatní požadované parametry, avšak u menších velikostí rukavic (velikost 6-6,5) mají délku 270 mm. Ostatní velikosti již splňují minimální délku 280 mm.

*Bylo by pro zadavatele přístupné upravit minimální požadovanou délku rukavic na 270 mm? Tyto menší velikosti rukavic jsou v praxi standardně vyráběny v kratších délkách, přesto však plně vyhovují z hlediska ochranné funkce a všech ostatních parametrů.*

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Zadavatel stanovil požadavek na minimální délku rukavic 280 mm v části 7 – rukavice operační latexové se zvýšenou citlivostí bez pudru, sterilní u všech nabízených velikostí z důvodu zajištění dostatečného krytí zápěstí a překrytí návleku operačního pláště. Tento požadavek vychází z požadavků zdravotnického personálu zadavatele a z jeho praktických zkušeností s používáním rukavic při operačních výkonech.



Nabídnuté rukavice s délkou 270 mm nejsou pro zadavatele akceptovatelné, neboť nehodlá slevit z požadavku na bezpečnost a komfort zdravotnického personálu. U kratších rukavic reálně hrozí vyhrnování rukávu pláště a odkrytí části předloktí, což může vést k narušení bariérové ochrany a zvýšení rizika kontaminace.

Zadavatel si je vědom, že běžně dostupné rukavice na trhu mají délku 280 mm i u menších velikostí, a v rámci průzkumu trhu zjistil, že většina relevantních dodavatelů nabízí rukavice splňující tento parametr.

Z výše uvedených důvodů zadavatel na požadavku minimální délky 280 mm u všech velikostí trvá.

---

Ing. Jaroslav Bednář  
vedoucí obchodního oddělení