

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Váš dopis značka / ze dne
20.08.2025

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
21.08.2025

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Dodávky injekčního materiálu pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.**”

Dotaz č. 1:

Zadavatel v části 3. požaduje periferní žilní kanyly s fixačními křídélky bez portu a v technické specifikaci požaduje bezpečnostní prvek - pasivní bezpečnostní klip kryjící hrot jehly bezprostředně po použití (zavedení jehly do žíly).

Zadavatel požaduje bezpečnostní kanyly v části 2. Odstraní zadavatel tento požadavek z části 3.?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel tento požadavek u části 3 - periferní žilní kanyly s fixačními křídélky bez portu odstranil.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje v části 3. u kanyly 14G (oranžová) zevní průměr 2,2mm. Bude zadavatel akceptovat zevní průměr 2,0mm při zachování požadované délky?

Zadavatel požaduje v části 3. u kanyly 16G (šedá) zevní průměr 1,7mm. Bude zadavatel akceptovat zevní průměr 1,75mm při zachování požadované délky?

Zadavatel požaduje v části 3. u kanyly 20G (růžová) zevní průměr 1,1mm. Bude zadavatel akceptovat zevní průměr 1,0mm při zachování požadované délky?

Zadavatel požaduje v části 3. u kanyly 24G (žlutá) zevní průměr 0,7mm. Bude zadavatel akceptovat zevní průměr 0,74mm při zachování požadované délky?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel bude Vámi uvedené zevní průměry kanyl akceptovat.


Dotaz č. 3:

Zadavatel v části 6. požaduje u stříkaček injekčních dvoudílných pro standardní jednorázové použití bezlatexový gumový píst.

Dvoudílné stříkačky pro standardní jednorázové použití neobsahují gumový píst. Jedná se o administrativní chybu?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, jedná se o administrativní chybu.

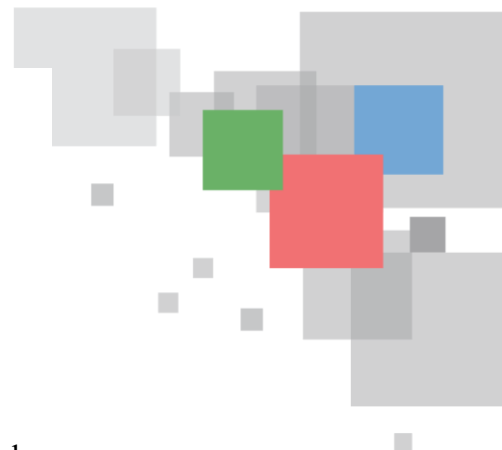

Dotaz č. 4:

Zadavatel v části 10. požaduje injekční stříkačku 50ml.
Bude zadavatel akceptovat injekční stříkačku 60ml?

Odpověď na dotaz č. 4:

Ne, zadavatel nebude akceptovat injekční stříkačku o objemu 60 ml.

Přílohy:

Zadávací dokumentace (ver. 21.08.2025)

P01 Technická specifikace vč. cenové nabídky (ver. 21.08.2025)

Současně zadavatel prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek**, a to **do 06.10.2025 do 10:00 hodin**.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení