

VŠEM UCHAZEČŮM

Váš dopis značka / ze dne

12.08.2015 (doručeno 17.8.2015)

Naše značka

BT/218/2015

Vyřizuje / linka

Ing. Tina Batková/5119

Karlovy Vary

20.08.2015

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „**Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN – infuzní systémy**“ – část 10, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 01. 07. 2015 pod evidenčním číslem VZ 483936.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN – infuzní systémy“ – část 10, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz:

1) Citace ZD: „Základní technická specifikace dodávky“

- Kompatibilita s MRI prostředím o velikosti 1,5 T

Trvá zadavatel na kompletnosti nabídky včetně kompatibility s MRI prostředím dle řešení uvedeném v zadávací dokumentaci?

Domníváme se, že trvání na požadavku přístrojů pro použití v MRI, vzhledem k unikátnosti produktu nabízeného pouze jedním možným dodavatelem jako součást celkové nabídky, vylučuje naši možnou účast ve výběrovém řízení.

2) Citace ZD: „Základní technická specifikace dodávky“

- Technické požadavky lineárního dávkovače

Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, U a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta a čase.

Domníváme se, že trvání na požadavku přístrojů pro výpočet rychlosti dávky v parametru mmol, vzhledem k unikátnosti parametru nabízeného pouze jedním možným dodavatelem, vylučuje naši

možnou účast ve výběrovém řízení. Domníváme se, že prvořadým zájmem zadavatele je otevřená soutěž pro dosažení nejlepší ceny. Při tomto zadání dochází k diskriminaci všech potenciálních uchazečů s výjimkou jednoho konkrétního dodavatele.

3) Citace ZD: „Základní technická specifikace dodávky“

- Technické požadavky infuzní pumpy

Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, U a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta a čase.


Domníváme se, že trvání na požadavku přístrojů pro výpočet rychlosti dávky v parametru mmol, vzhledem k unikátnosti parametru nabízeného pouze jedním možným dodavatelem, vylučuje naši možnou účast ve výběrovém řízení. Domníváme se, že prvořadým zájmem zadavatele je otevřená soutěž pro dosažení co nejlepší ceny. Při tomto zadání dochází k diskriminaci všech potenciálních uchazečů s výjimkou jednoho konkrétního dodavatele.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel trvá na požadavku kompatibility přístrojů s MRI prostředím o velikosti 1,5 T a na výpočtu rychlosti dávky v parametru mmol. Zadavatel nesouhlasí s tvrzením, že existuje pouze jeden dodavatel, který by splnil zadávací dokumentaci. Dle jeho průzkumů existuje hned několik různých výrobků od různých výrobců, které tyto absolutní požadavky splní.

Uchazeč evidentně nezná portfolio nabízených produktů na trhu. Zadavatel může považovat položený dotaz uchazeče jako obstrukční jednání a účelové napadnutí probíhající soutěže.

Jelikož se nejedná o žádnou změnu v zadávacích podmínkách, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

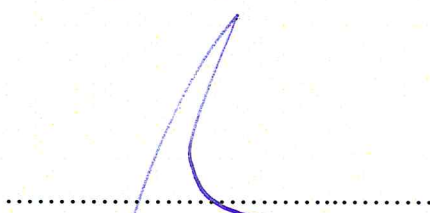

MUDr. Josef März
předseda představenstva

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nemocnice v Karlových Varech, IČ: 263 65 804
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 111, fax: 353 115 178

(2)