

VŠEM ÚČASTÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
06.06.2017Naše značka
BY/38/2017Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/119Karlovy Vary
07.06.2017

Vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „**Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 47**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 05. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-014314

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) Vám podáváme vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 47“, které vyplývá z níže uvedených dotazů.

Dotaz:


Jsou hranice x-y za maximální, mají tedy nabízené sondy ležet v rozsahu x-y MHz nebo je míněno, že tento rozsah je minimální a je požadováno aby nabízené sondy tedy tento rozsah co do šíře přesahovaly?

Tedy prakticky nám v dotazu jde o to, zda:

- Bude akceptována sonda pro kardiologické vyšetření dospělých s frekvenčním rozsahem 1,3 – 4,4 MHz?
- Konvexní širokopásmová pro abdominální vyšetření s rozsahem 1,4 – 5,0 MHz?
- Lineární pro vyšetření periferních cév a karotid s rozsahem 5,0 – 15,0 MHz?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Formulář technické specifikace, u položek *Sonda pro kardiologické vyšetření dospělých*, *Konvexní širokopásmová sonda pro abdominální vyšetření*, *Lineární sonda pro vyšetření periferních cév a karotid*, šíře cca 4 cm, uvádí frekvenční rozsahy v max. rozsahu, tzn. nabízené rozsahy všech sond dotazujícího se účastníka zadávacího řízení jsou v pořádku.

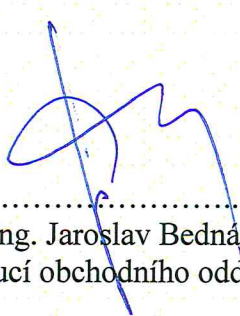

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení