

VŠEM ÚČASTÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
8.8.2018

Naše značka
BY/171/2018

Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/119

Karlovy Vary
13.8.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „**Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 10**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 07. 2018 pod evidenčním číslem zakázky Z2018-023497

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) Vám podáváme vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 10“, které vyplývá z níže uvedených dotazů.

Dotazy:

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v technické specifikaci „Obě energie jsou přenášeny simultánně jedinou sondou, ne kombinace více sond najednou“. Bude Zadavatel akceptovat řešení dvou sond, které jsou pevně spojeny a které mají stejné náklady a životnost jako popsané řešení?

Dotaz č. 2

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „Funkčnost obou energií bez nutnosti napojení na tlakové rozvody či kompresor“. Studie s impakt faktorem dokazují, že rázová energie vytvářená stlačeným vzduchem má při lithiáze signifikantně větší účinnost. Verze přístroje s integrovaným kompresorem navíc nepřináší jakoukoli nevýhodu oproti řešení bez stlačeného vzduchu. Ptáme se proto, zdali bude Zadavatel akceptovat řešení s integrovaným kompresorem?

Dotaz č. 3

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „Ovládání přístroje start/stop přímo z měniče v ruce operátora“. Bude Zadavatel akceptovat ovládání pomocí pedálu?

Dotaz č. 4

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „Nastavení úrovně odsávání konkrementů přímo na měniči v ruce operátora“. Bude Zadavatel akceptovat ovládání pomocí pedálu?

Dotaz č. 5

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „Nastavení úrovně výstupního výkonu litotriptoru na měniči v ruce operátora“. Bude Zadavatel akceptovat nastavení na panelu přístroje?

Odpovědi na dotazy:**Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel na tomto požadavku trvá.

Primárním důvodem nebyly náklady na pořízení dvou sond, ale nesporné výhody vycházející z tohoto řešení. Při použití jedné kombinované sondy je větší lumen pro odsávání konkrementů, než při kombinaci dvou sond. A také, což je podstatné, lze využít výhody kombinované technologie nejen při PEK výkonech, ale i při miniPEKu a ureteroskopii (tzn. i v průměrech kolem 1,0 - 1,5mm).

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel na tomto požadavku trvá.

Zadavatel požaduje umístění řídicí jednotky litotriptoru na poptávaný vozík, který bude dále doplněn o další přístroje endo-urologického vybavení. Tudíž požaduje malý kompaktní systém, který nebude na dalším samostatném vozíku opatřeném kompresorem. Dále zadavatel nesouhlasí s tvrzením dotazujícího, že kompresor nepřináší žádné nevýhody, např. hluchost a množství vstupních prvků do sondy.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel na tomto požadavku trvá.

Zadavatel požaduje ovládání funkcí z rukou operátora, který potřebuje mít volnou nohu pro ovládání skiaskopického přístroje během provozu lithotriptoru.

Odpověď na dotaz č. 4

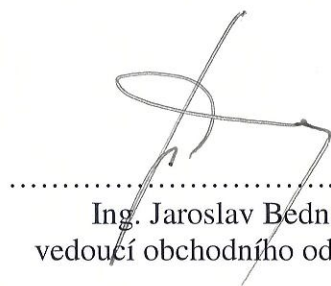
Zadavatel na tomto požadavku trvá

Zadavatel požaduje ovládání funkcí z rukou operátora, který potřebuje mít volnou nohu pro ovládání skiaskopického přístroje během provozu lithotriptoru.

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel na tomto požadavku trvá.

Zadavatel požaduje ovládání funkcí z rukou operátora pro zachování kautel sterility


.....
Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení